

Spettabile
Azienda Sanitaria della Provincia
Autonoma di Bolzano
Via Ospedale, 11
39031 BRUNICO

Oggetto: *Procedura aperta per la fornitura di un polo di diagnostica per immagini con risonanza magnetica (GG01/2012) e TAC (GROS001/2016) al Comprensorio Sanitario di Brunico con l'opzione della fornitura di un tomografo computerizzato al Comprensorio Sanitario di Bressanone*
Vostra pubblicazione su Unione Europea del 21.07.2016

Data: 29 luglio 2016
Rif. IS/16/0370/RS/al

RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (ai sensi degli art. 79 del D.Lgs 50/2016)

La sottoscritta Philips S.p.a., con sede legale in Milano – via Mascheroni 5, ed uffici in Monza, via Casati, 23, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00856750153 (corrispondente al n. di codice Fiscale e P.IVA) ed al R.E.A. di Milano al n. 88001, con capitale sociale versato Euro 68.068.000,00=, in persona del Consigliere di Amministrazione ed Amministratore Delegato Dr. Carluccio Giuseppe CAMNASIO, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Premesso che:

- la istante Società ha interesse a partecipare alla gara emarginata
- la istante Società, necessita, per la più corretta formulazione della propria offerta, di chiarimenti ed informazioni ulteriori in merito a talune disposizioni dei documenti di gara,

CHIEDE i seguenti chiarimenti

- 1) si chiede di conoscere i dati relativi ai due sistemi TC Somatom Sensation 64 oggetto di ritiro, e in particolare
 - Numero di rotazioni del gantry
 - Numero di secondi (o colpi) di scansione del tubo radiogeno
 - Data di ultima sostituzione del tubo radiogeno
 - Versione del software



PHILIPS


- Presenza o meno (ed eventualmente tipo) di sistema di ricostruzione iterativa
- 2) relativamente alle due workstation Syngo Workspace 3D e Syngo TC 3D Multimodality oggetto di ritiro, si chiede di conoscere la dotazione software presente sulle due stazioni.
- 3) a pagina 6 del "capitolato speciale" è indicato "Tempo di scansione minimo su 360° non superiore a 0,3 secondi". Si chiede di eliminare tale requisito, ovvero di modificarlo in "Tempo di scansione minimo su 360° non superiore a 0,4 secondi", in quanto un tempo di rotazione così ridotto non è necessario per la destinazione d'uso indicata a pag. 5 per cui i sistemi sono richiesti (indagini di routine, vascolare, body, neurologico, oncologico).
La modifica richiesta è da intendersi nell'ottica di garantire una maggiore e più ampia partecipazione alla procedura di gara.

In considerazione della brevità del termine con richiamo ai chiarimenti richiesti, prega di riscontrare la presente con la massima urgenza, al seguenti recapiti:

Philips Spa- Ufficio Gare – Via G. Casati n. 23 – 20900 MONZA (MB) Tel.039/2031 – fax 039/2036205 – e-mail ufficiogare@philips.com;

PEC: garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it;

Con osservanza.

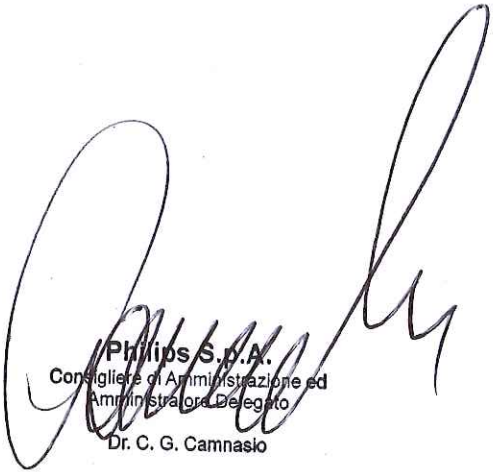

Philips S.p.A.
Consigliere di Amministrazione ed
Amministratore Delegato
Dr. C. G. Camnasio